

マイティス・アローインプラント

Mytis ArrowImplant



マイティス・アローインプラントは
化学的生体力学に基づいた、細部までの丁寧な設計・デザイン。
機能・形態ともに生体親和性に優れた純国産インプラントです。

マイティスアローインプラントシステム

当社では、 β -TCP を材料とした製品を多数製造しており、特に HA・TCP でプラスト表面処理したインプラントと β -TCP 骨造成材、 β -TCP 歯面研磨材は共に使用することで相乗効果を発揮します。これらの製品はすべて自社生産、国産品で、米国 FDA を取得済みです。

Cure

歯を治す

Recovery

骨を造る

Mytis ArrowImplant System

ArrowBone- β -Dental (骨補填材)

Maintenance

歯と骨を守る

β パウダー (歯面研磨材)

骨置換性に優れた β -TCP 骨補填材

β -TCP の球状粉末歯面研磨材



吸収性歯科用骨再建インプラント材

高度管理医療機器(クラスIV)

ArrowBone- β -Dental™

アローボーン- β -デンタル



歯面研磨剤

一般医療機器

β-POWDER

β パウダー



医療機器届出番号：13B1X00145000005

医療機器承認番号：22500BZX00553000



製造販売元

株式会社 ブレーンベース


【本社】〒140-0014 東京都品川区大井 1-49-15 YK-17 ビル 6 階
TEL.0120-25-4929 FAX.0120-4929-37 <http://www.brain-base.com>

TCガムプロテクト


新製品

余剰セメント除去シート

インプラント脱落の大きな原因となっている「余剰セメント」
TCガムプロテクトは余剰セメントを完全ガード

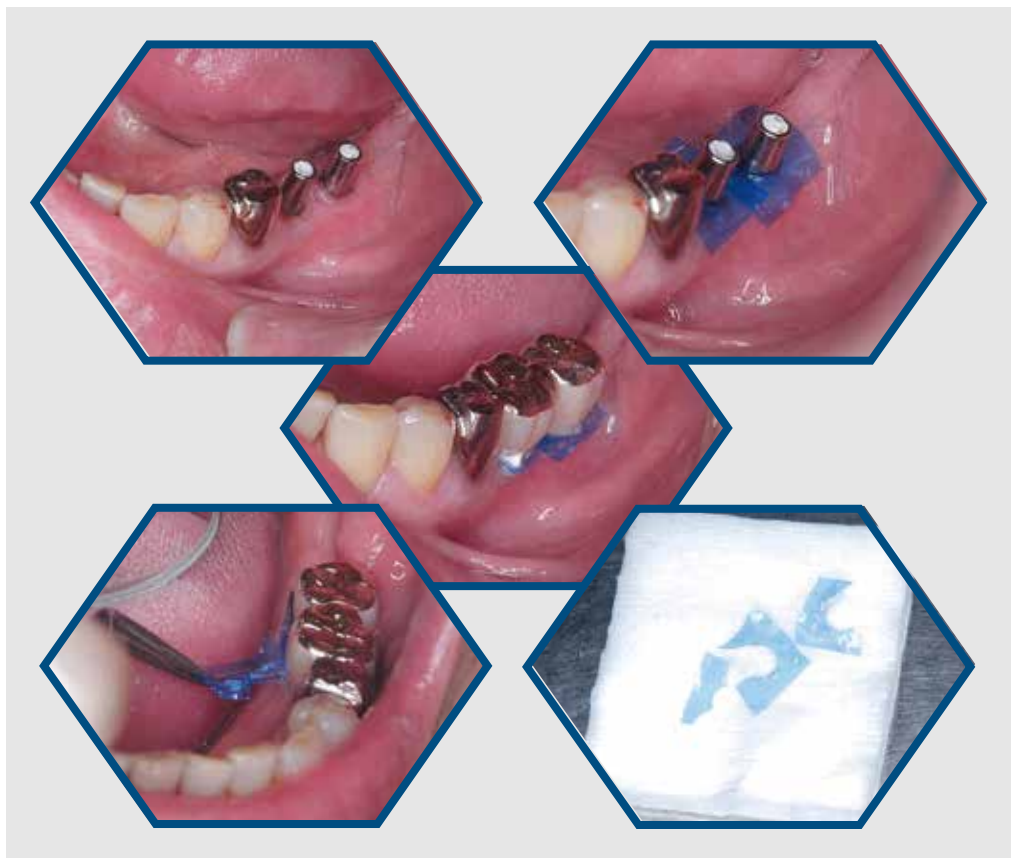

実寸^{タテ}12mm×^{ヨコ}20mm
直径3.5mm

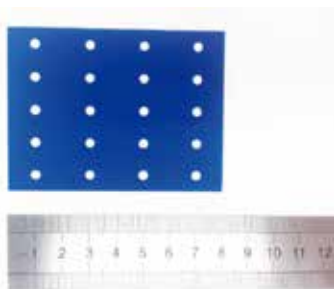

¥6,000 (税抜)

1シート 20枚入り

医療機器製造販売届出番号 13B1x00145000029

一般医療機器 歯科用ラバーダム

製品名 TCガムプロテクト

貴院名				ご氏名		
ご住所	〒					
TEL	FAX		ご注文		セット	

恐れ入りますが、右記まで FAX くださいますようお願い致します。

▶▶▶ FAX 0120-4929-37



株式会社ブレンベース

〒140-0014 東京都品川区大井 1-49-15 YK-17 ビル 6階

電話：03-3778-0745 E-mail:mail@brain-base.com